



# Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

## LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

No. SSS-LA-002-2018

### "EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO"

#### ACTO DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES AL CONTENIDO DE LAS BASES

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA TRECE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, SE REUNEN EN LA SALA DE JUNTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, UBICADA EN CALLE CERRO MONTEBELLO ORIENTE 150, MONTEBELLO LOS ING. GILBERTO OSCAR CASILLAS BARAJAS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS DE SAUD DE SINALOA, LIC. NORMA AURORA ARCE MIRANDA, SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, LIC. IGNACIO JOSÉ ZAVALA ESCAJADILLO, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA, LIC. EDGAR JOEL CASTRO SOTO, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA, LIC. JOSÉ LUIS RAMÓN VAZQUEZ, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE NORMATIVIDAD, ING. RAFAEL DAVID DE LA PEÑA PIÑA, INGENIERO BIOMEDICO DEL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE EQUIPO MEDICO, DR. JUAN MANUEL GARCÍA DIAZ, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD, LIC. CLAUDIA MARIA ESPINOSA JAUREGUI, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, TODOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, CUYA PERSONALIDAD JURIDICA SE ACREDITA EN LOS ARTICULOS 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL ESTADO DE SINALOA Y 63 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, EL ARQ. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES, C. ROSA GARCÍA ESTRELLA, REPRESENTANTE DE ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A., C. GRISELDA LOPEZ RAMIREZ, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA DICIPA, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES AL CONTENIDO DE LAS BASES, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. SSS-LA-002-2018, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO".-----

EN USO DE LA PALABRA, EL ING. GILBERTO OSCAR CASILLAS BARAJAS, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y FUNCIONARIO PÚBLICO AUTORIZADO PARA QUE PRESIDA EL EVENTO, TOMA NOTA DE LOS PARTICIPANTES AL EVENTO, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE Y MARGEN DE LA PRESENTE ACTA.-----

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDIÓ A DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS DE LOS LICITANTES ASISTENTES AL PRESENTE EVENTO, DETALLÁNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

#### 1.- ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
1.- DENTRO DE LAS PRECISIONES DE LA CONVOCANTE SOLICITAN LO SIGUIENTE: "4.- ALTURA DEL FOCO AL PISO O SID DE 0.6 O MENOR A 1.90 M O MAYOR." PREGUNTA: SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UNA "ALTURA DEL FOCO AL PISO SID DE 0.758 M O MENOR A 1.90 M O MAYOR", YA QUE POR PROTOCOLO LOS ESTUDIOS CONVENCIONALES SE DEBEN REALIZAR A 1.00 M DE DISTANCIA PARA EVITAR FALSO POSITIVOS CON LAS ESTRUCTURAS ANATÓMICAS, ES DECIR MEDIDAS INCORRECTAS POR LA MAGNIFICACIÓN DE LA IMAGEN EN LA ANATOMÍA HUMANA DE	SE ACEPTA PROPUESTA SIN SER LIMITATIVA



SERVICIOS DE SALUD  
DE SINALOA

# Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

## LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

No. SSS-LA-002-2018

### "EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO"

<p>NEONATOS Y HASTA ADULTOS MAYORES. DEJANDO FUERA ESTUDIOS DE TELE DE TÓRAX YA QUE ESTOS DEBEN DE SER A 1.70 M JUSTO PARA TENER LA MAGNIFICACIÓN ADECUADA DE ESA REGIÓN, Y EN LOS CASOS DONDE LOS NEONATOS SE ENCUENTRAN EN CUNAS ES LA ALTURA DE LA CUNA MÁS LA DISTANCIA FOCO OBJETIVO DE MÍNIMO 0.80 M POR LAS LÁMPARAS DE CALOR RADIANTE; LO ANTERIOR EN EL ENTENDIDO QUE CON EL RANGO SOLICITADO SE PUEDEN EFECTUAR TODOS LOS PROCEDIMIENTOS RADIOGRÁFICOS, INCLUIDO MIEMBROS INFERIORES, POR LO CUAL LA CAPACIDAD CLÍNICA NO SE LIMITA EN FORMA ALGUNA. A CONTINUACIÓN, EL ESQUEMA DE LA PRECISIÓN. <b>SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UNA "ALTURA DEL FOCO AL PISO SID DE 0.758 M O MENOR A 1.90 M O MAYOR. ¿SE ACEPTA?</b></p>	
<p>2.- EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR, AGRADECEREMOS NOS PUEDAN INDICAR EL ESTUDIO CLÍNICO O ANATOMÍA HUMANA QUE REQUERIRÁ HACER LA CONVOCANTE PARA SOLICITAR UNA "ALTURA DEL FOCO AL PISO O SID DE 0.6 M O MENOR". FAVOR DE INDICAR EL ESTUDIO CLÍNICO QUE NECESITAN REALIZAR.</p>	<p>NO APLICA, DADO QUE LA RESPUESTA ANTERIOR FUE POSITIVA.</p>
<p>3.- DADO QUE LA ADECUACIÓN DE ÁREA SERÁ RESPONSABILIDAD DE SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, AGRADECEREMOS SE NOS INDIQUE A PARTIR DE QUÉ MOMENTO INICIARÁ EL PERIODO DE GARANTÍA DEL EQUIPO Y POR CUANTO TIEMPO YA QUE ESTOS EQUIPOS CUENTAN CON ELEMENTOS AL ALTO VACÍO Y REQUIEREN CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO, LAS CUALES SERÁN RESPONSABILIDAD DE LA CONVOCANTE; ESTO DEBIDO A QUE EN EL MODELO DE CONTRATO NO LO ESPECIFICAN, DICE: "DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA "EL PROVEEDOR" PROPORCIONARÁ, PERIODO DE GARANTÍA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON MANO DE OBRA, REFACCIONES, CONSUMIBLES Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE EN SU CASO FUESEN NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS", EL CUAL ES DIFERENTE A LA "CARTA GARANTÍA POR 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS" SOLICITADA EN BASES. <b>POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS AMABLEMENTE INDICAR LOS ALCANCES DE LAS GARANTÍAS, EL PERIODO Y LAS RESPONSABILIDADES PARA EL PROVEEDOR.</b></p>	<p>EL PERIODO SE TOMARA EN CUENTA A PARTIR DE LA PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO SIENDO POR UN PERIODO DE 24 MESES Y LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LAS BASES.</p>

#### 2. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTIC, S. DE R.L. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>1.- EN BASE A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA DEL LICITANTE DICIPA, UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL (RX DIGITAL), PUNTO 1.1 DONDE SE MODIFICA LA POTENCIA DE AL MENOS A 40KW, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFRECER PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA PUNTO 30 KW O MAYOR LO CUAL CUMPLE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-229-SSA1-2002 DONDE SE MENCIONAN EN EL PUNTO "9.1.6.</p>	<p>NO SE ACEPTA, LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES ES PARA DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS RELACIONADAS A LAS CARACTERISTICAS ADICIONADAS EN LA PASADA JUNTA DE ACLARACIONES Y EL</p>

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO SSS-LA-002-2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO"



SERVICIOS DE SALUD  
DE SINALOA

# Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

## LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

No. SSS-LA-002-2018

### “EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO”

<p>EQUIPOS MÓVILES DE RAYOS X CON GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA, CON UNA POTENCIA NO MAYOR DE 30 KW” Y CONSIDERAR EL CUMPLIMIENTO DE NO EXPONER AL PERSONAL Y PACIENTES A LA RADIACIÓN DISPERSA POR POTENCIAS MAYORES LAS CUALES DEBEN ESTAR CONFINADAS A CUARTOS CON PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>ULTIMO PARRAFO DE LA PAGINA 9, TODO LO ACORDADO EN LA JUNTA ANTERIOR NO SERA SUJETO A MODIFICACIONES.</p>
<p>2.- EN BASE A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA DEL LICITANTE DICIPA, UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL (RX DIGITAL), PUNTO 1.3 DONDE SE MODIFICA EL KILOVOLTAJE A 150KV O MAYOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFRECER PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA PUNTO 130KV O MAYOR LO CUAL SUPERA A LO ORIGINALMENTE SE ESTABA SOLICITADO EN LA PUBLICACIÓN DE LAS BASES, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA, LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES ES PARA DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS RELACIONADAS A LAS CARACTERISTICAS ADICIONADAS EN LA PASADA JUNTA DE ACLARACIONES Y EL ULTIMO PARRAFO DE LA PAGINA 9, TODO LO ACORDADO EN LA JUNTA ANTERIOR NO SERA SUJETO A MODIFICACIONES.</p>
<p>3.- EN BASE A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA DEL LICITANTE EYMSA, UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL (RX DIGITAL), PUNTO 2.2 DONDE SE MODIFICA LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TÉRMICO EN EL ÁNODO A 300KHU O MAYOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFRECER PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA PUNTO 100KHU O MAYOR LO CUAL SUPERA A LO ORIGINALMENTE ESTABAN SOLICITADO EN LA PUBLICACIÓN DE LAS BASES, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA, LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES ES PARA DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS RELACIONADAS A LAS CARACTERISTICAS ADICIONADAS EN LA PASADA JUNTA DE ACLARACIONES Y EL ULTIMO PARRAFO DE LA PAGINA 9, TODO LO ACORDADO EN LA JUNTA ANTERIOR NO SERA SUJETO A MODIFICACIONES.</p>
<p>4.- ACLARACIÓN DE LA CONVOCANTE AL PUNTO 4.- ALTURA DEL FOCO AL PISO O SID DE 0.6 METROS O MENOR A 1.90 METROS O MAYOR.; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFRECER PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA PUNTO: ALTURA DEL FOCO AL PISO O SID DE 1.0 METROS O MENOR A 1.80 METROS O MAYOR. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA SIN SER LIMITATIVO</p>

LAS ACLARACIONES, ACUERDOS Y MODIFICACIONES TOMADAS EN LA PRESENTE REUNIÓN, PASAN A FORMAR PARTE INTEGRAL DE LAS BASES EMITIDAS PARA LA PRESENTE LICITACIÓN.-----

SE HACE DE CONOCIMIENTO, QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA SE PROPOSICIONES SE EFECTUARA EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2018 A LAS 10:00 HORAS.-----

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN, SE DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA EN COMPRANET, EN LA DIRECCIÓN: [COMPRANET.SINALOA.GOB.MX](http://COMPRANET.SINALOA.GOB.MX), DICHO PROCEDIMIENTO SUSTITUIRÁ A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. ASIMISMO, SE MANTENDRÁ UN EJEMPLAR PARA SU CONSULTA EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, UBICADA EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, AL CUAL TENDRÁ ACCESO EL PÚBLICO O CUALQUIER INTERESADO PARA CONSULTA, POR UN TÉRMINO DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE ACTO, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA.-----

# Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES









## LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

No. SSS-LA-002-2018

### “EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO”

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS ONCE HORAS DEL MISMO DÍA DE INICIADO EL PRESENTE, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PREVIA LECTURA DE LA MISMA.-----

**POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS:**

ING. GILBERTO OSCAR CASILLAS BARAJAS. DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	
LIC. NORMA AURORA ARCE MIRANDA. SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES	
LIC. IGNACIO JOSÉ ZAVALA ESCAJADILLO. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCION MEDICA	
LIC. EDGAR JOEL CASTRO SOTO. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA.	
LIC. JOSE LUIS RAMON VAZQUEZ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE NORMATIVIDAD.	
ING. RAFAEL DAVID DE LA PEÑA PIÑA INGENIERO BIOMEDICO DEL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE EQUIPO MEDICO	
DR. JUAN MANUEL GARCÍA DÍAZ. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.	
LIC. CLAUDIA MARÍA ESPINOSA JAUREGUI. JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN RECURSOS MATERIALES.	

**POR LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS**

ARQ. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ.	
--------------------------------	---





# Servicios de Salud de Sinaloa



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

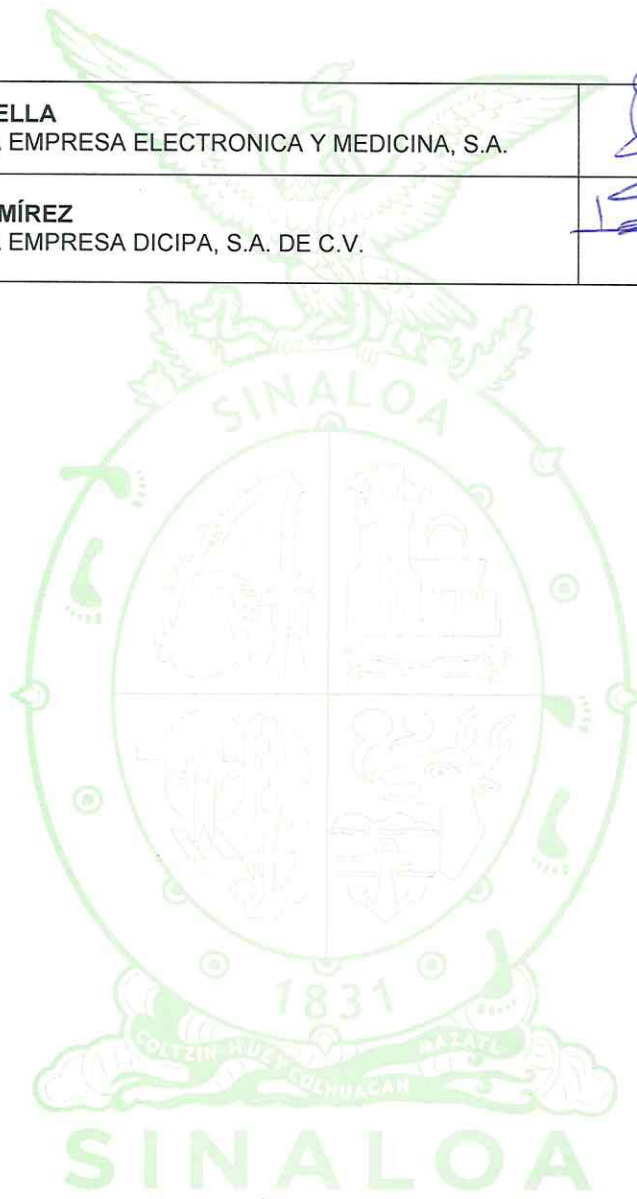
## LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

No. SSS-LA-002-2018

“EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO”

POR LOS LICITANTES:

<b>C. ROSA GARCÍA ESTRELLA</b> REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.	
<b>C. GISELDA LÓPEZ RAMÍREZ</b> REPRESENTANTE DE LA EMPRESA DICIPA, S.A. DE C.V.	



LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO SSS-LA-002-2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE “EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO”

